



## Características técnicas

Uso previsto	Periodoncia				
Indicaciones de uso	Desbride periodontal y pulido radicular				
Descripción	Inserto diamantado para el pulido de los dientes anteriores en casos simples, en la zona cervical, y para la retirada de los tejidos de granulación.				
Tipo de inserto	Diamantado				
Factor alergénico	Inserto fabricado con acero inoxidable quirúrgico conforme a la norma ASTM F899 - 12b  El acero quirúrgico inoxidable contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Níquel</li> <li>• Cromo</li> </ul> La aleación del aglutinante de engaste del diamantado contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Níquel</li> </ul>				
Referencia comercial	H1 : F00366				
Clase médica	El dispositivo médico es de clase IIa según la directiva europea 93/42/CEE.				
Ajustes	Gama Newtron	Gama P5	Suprasson P5 Booster	Prophy Max - P-Max - Implant Center 2 - Piezotome 2	
	2	2	1	2	

## Vida útil

Como no se puede establecer un número máximo de utilizaciones, ya que puede depender de muchos parámetros como la duración de utilización, la duración de los tejidos, el esfuerzo ejercido o el desgaste, le recomendamos que renueve, como mínimo, una vez al año los dispositivos médicos que utilice normalmente. Proceda a la renovación del dispositivo médico si el inserto no vibra con la frecuencia esperada, el tratamiento no se desarrolla como de costumbre y tarda más tiempo o no progresa.


## Documentos relacionados

Nombre del documento	Referencias
Modo de consulta de las instrucciones de uso electrónicas	J00007
Protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de los insertos	J02004
Ficha clínica Periodoncia	J08024
Tabla de ajuste de potencia de los generadores de ultrasonidos	J58000
Folleto general relativo al conjunto de la gama de los insertos dentales convencionales	J02101


## Esterilización




Esterilizar antes de utilizar




Debe desinfectar, limpiar y esterilizar el inserto antes y después de cada utilización. Antes de cualquier utilización, consulte los Protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de los insertos J02004.

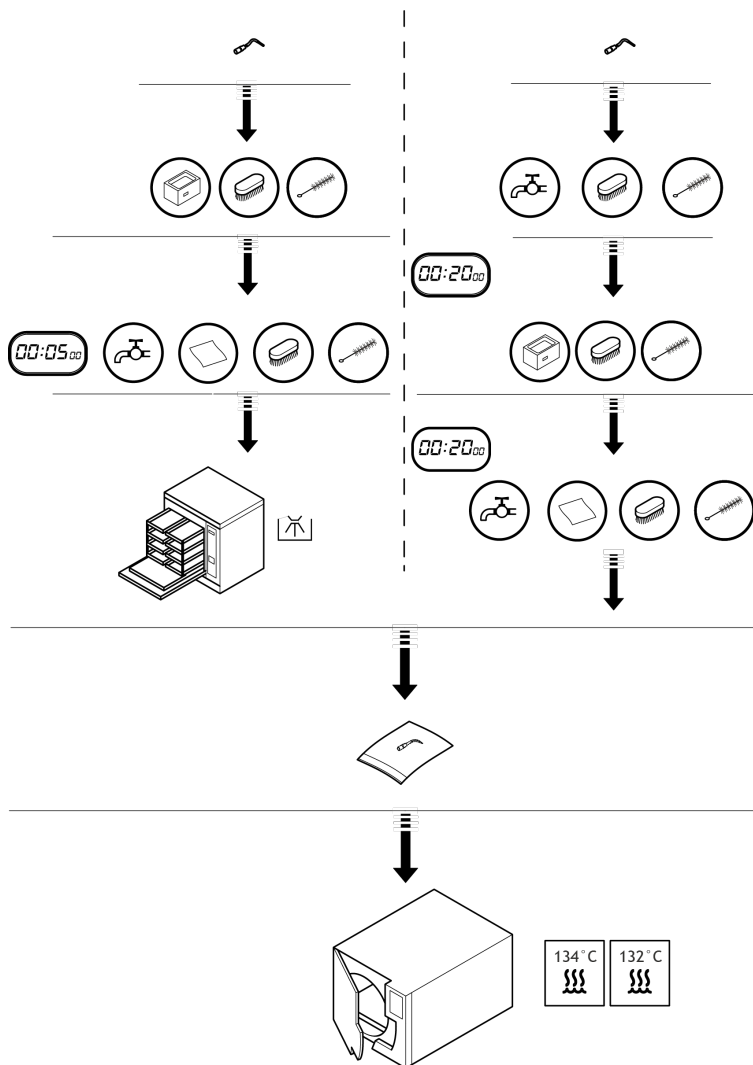

## Colocación



## Desmontaje



## Identificación del fabricante



SATELEC  
A Company of ACTEON Group  
17, avenue Gustave Eiffel  
BP 30216  
33708 MERIGNAC cedex  
Francia  
Tel. +33 (0) 556.34.06.07  
Fax. +33 (0) 556.34.92.92  
E.mail : satelec@acteongroup.com  
www.acteongroup.com



## Fecha de primera fijación de la marca CE

1998



El facultativo debe visualizar continuamente el estado del sitio clínico para descubrir inmediatamente cualquier riesgo

Inserto | H1 | J00174 | (98) | V2 | 05/2018 | NB11ES010B

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group  
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANCIA  
Tel. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92  
E-mail : satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download



Instructions For Use

