


IMPRESIONES

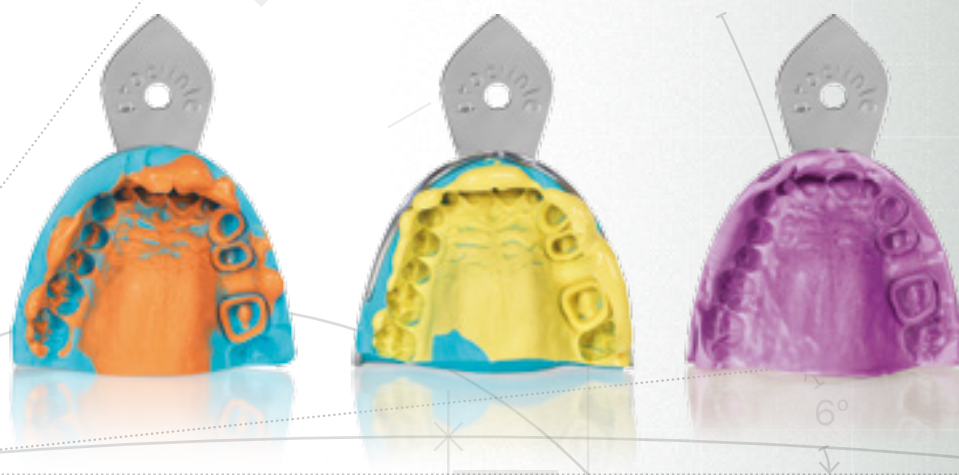

IMPRESIONANTEMENTE FÁCILES Y PRECISAS

En cualquier técnica:
uno o dos pasos y monofase


Las siliconas **Proclinic Expert** te garantizan la máxima precisión y calidad

La combinación de la nanotecnología y la hidrofilia de su material te ofrecen impresiones detalladas, exactitud dimensional asegurada y total integridad de los márgenes.



Excelente
reproducción
de detalles

Alta hidrofilia,
ángulo
de contacto
menor a 10°

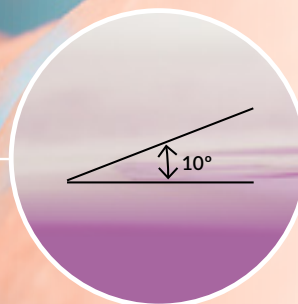

Gran elasticidad
y resistencia
al desgarro

Versátil
para las
técnicas de
1 y 2 pasos
y monofase

Perfecta
tixotropía,
sin burbujas
ni goteo



Dr. Alexander Johansson
Clínica ZahnCity GmbH, Zurich, Suiza
www.zahncity.ch

"Nunca había probado antes una silicona ultra ligera y he encontrado que la silicona Proclinic Expert Ultra Light Body es mejor que la silicona Light Body que uso habitualmente."



Dr. Eduardo González Arroyo
Clínica Fernández, Ibiza, España
www.oralsturgerytube.com
Número colegiado 28007247

"Estas siliconas tienen un nivel de calidad superior a las anteriores siliconas de marca Proclinic que utilizaba habitualmente."

Las siliconas
Proclinic Expert
cuentan con
la recomendación
de los profesionales:



Dr. Carlos Gargallo
Clínica Carlos Gargallo,
Barcellona, España
Número colegiado 3947


"La gama de siliconas Proclinic Expert se comporta muy satisfactoriamente en todas las técnicas de impresiones habituales. Tanto si son tipo Regular Body como Ultra Light Body ofrecen un grado de detalle, consistencia y manejo muy buenos, ideales para prótesis fija, ortodoncia invisible y rebases. Si realizamos doble impresión, las siliconas Proclinic Expert Putty manuales y de mezcla automática se recortan fácilmente con bisturí."



Las siliconas **Proclinic Expert** permiten una toma de impresiones fácil y rápida

Con tiempos correctamente modulados y diferentes viscosidades para cada necesidad clínica.

Excelente reproducción del detalle en ambiente húmedo, alta hidrofilia que minimiza el riesgo de poros. Consiga impresiones de gran precisión gracias a las excelentes propiedades de las siliconas Proclinic Expert.

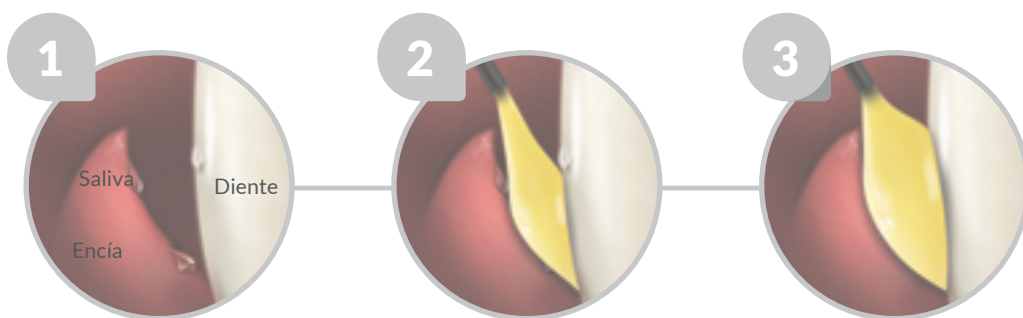

*Tiempos a 23° C	Ultra Light Body	Light Body	Light Body	Regular Body	380 Heavy Body	380 Heavy Body	380 Putty Soft	Putty Soft	Putty Soft
	Fast Set	Regular Set	Fast Set	Regular Set	Regular Set	Fast Set	Fast Set	Regular Set	Fast Set
Reorder	15156	15153	15154	15152	15158	15159	15157	15150	15151
ISO 4823	Type 3	Type 3	Type 3	Type 2	Type 1	Type 1	Type 0	Type 0	Type 0
ADA 19	Light-bodied Consistency	Light-bodied Consistency	Light-bodied Consistency	Medium-bodied Consistency	Heavy-bodied Consistency	Heavy-bodied Consistency	Putty Consistency	Putty Consistency	Putty Consistency
Proporción mezcla	1:1	1:1	1:1	1:1	5:1	5:1	5:1	1:1	1:1
Sistema									
Tipo de mezcla	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Hand mixing	Hand mixing
Tiempo total de trabajo	1'30"	2'	1'30"	2'	2'	1'30"	1'30"	2'	1'30"
Permanencia mínima en boca	2'30"	3'30"	2'30"	3'30"	3'30"	2'30"	2'30"	3'30"	2'30"
Tiempo de fraguado*	4'	5'30"	4'	5'30"	5'30"	4'	4'	5'30"	4'
Deformación por presión (min - max)	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	1- 3%	1- 3%	1- 3%
Memoria elástica	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99%	> 99%	> 99%
Variación dimensional lineal 24 horas	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%
Dureza "Shore A"	45±2	45±2	45±2	45±2	60±2	60±2	60±2	60±2	60±2
Técnicas sugeridas	2 pasos 	1 paso o 2 pasos 	1 paso o 2 pasos 	1 paso o 2 pasos 	1 paso o 2 pasos 	1 paso o 2 pasos 	1 paso o 2 pasos 	1 paso o 2 pasos 	1 paso o 2 pasos
	BAJA CONSISTENCIA							ALTA CONSISTENCIA	

Complete su gama de siliconas con la silicona Proclinic Expert para el Registro de Mordida.
Una silicona de dureza 95 Shore A (15160) que garantiza una excelente reproducción de detalles.

Las siliconas **Proclinic Expert** se adaptan a todas las técnicas de impresión


TÉCNICA DE UN PASO

PUTTY SOFT FAST	Tiempo de trabajo 1'30"	Permanencia mínima en boca 2'30"
LIGHT BODY FAST	Tiempo de trabajo 1'30"	Permanencia mínima en boca 2'30"



TÉCNICA DE DOS PASOS

PUTTY SOFT REGULAR	Tiempo de trabajo 2'	Permanencia mínima en boca 3'30"
ULTRA LIGHT BODY	Tiempo de trabajo 1'30"	Permanencia mínima en boca 2'30"

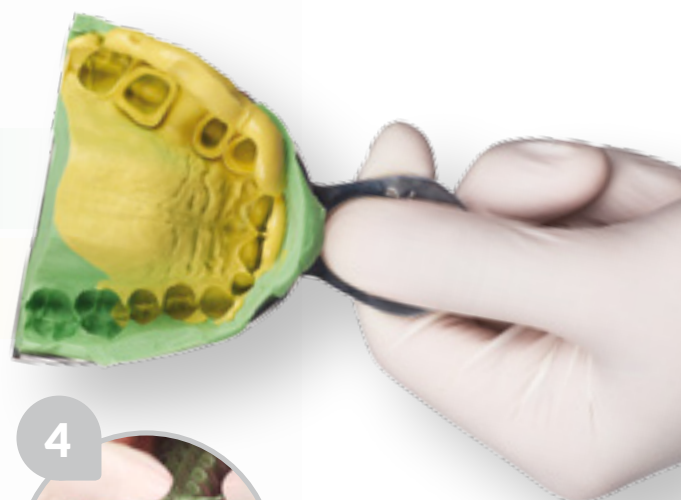

Las siliconas **Proclinic Expert** consiguen una excelente nota en los tests clínicos



373
APLICACIONES
CLÍNICAS



87%

de los consultores consideraron
las siliconas Proclinic Expert
**TAN BUENAS
O MEJORES**
que las que utilizaban
habitualmente



| www.proclinic.es | 900 39 39 39 | info@proclinic-products.com |



 **proclinic**
EXPERT