FICHA TÉCNICA

BRUÑIDORES BOLA LM	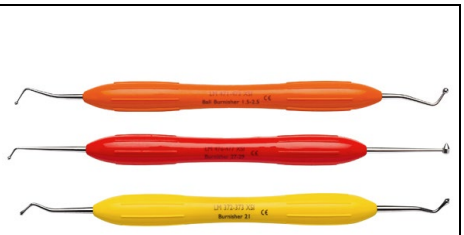
REFERENCIAS	**4270:** BRUÑIDOR BOLA 471-473 LM **4271:** BRUÑIDOR BOLA 27-29 - 476-477 LM
FABRICANTE / RESPONSABLE	**LM-Instruments Oy** Norrbyn rantatie 8 FI-21600 Parainen – Finlandia Tel.: +358 2 4546 400 Email: info@lm-dental.com Web: www.lm-dental.com
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745.
DESCRIPCIÓN	◇ **Modelo 471-473** Bruñidor doble extremo con puntas esféricas de 1,5 mm y 2,5 mm, diseñado para obturación y modelado de composite, especialmente para dar forma y alisar el material restaurador en cavidades. Mango de silicona ergonómico (ErgoMax™), con excelente agarre y control táctil. ◇ **Modelo 476-477** Bruñidor de bola para uso en superficies oclusales y bordes de cavidades. Facilita el moldeado y adaptación del composite durante la restauración. Mango de silicona ergonómico (ErgoMax™), con excelente agarre y control táctil.
ESPECIFICACIONES	• Instrumento manual reutilizable. • Material activo: acero quirúrgico inoxidable de alta resistencia. • Mango: silicona técnica con diseño ergonómico. • Diámetros de bola (471/473): 1,5 mm y 2,5 mm. • Forma de trabajo (476/477): esferas adaptadas para modelar áreas de masticación y sellar bordes. • Totalmente esterilizable en autoclave conforme a los protocolos habituales.
COMPOSICIÓN	Puntas: acero inoxidable médico. Mango: polímero técnico antideslizante de silicona (LM-ErgoMax™).
ENVASE	Contiene una unidad.
VIDA ÚTIL	Entre 1 y 3 años, dependiendo del uso, esterilización y mantenimiento.
INSTRUCCIONES DE SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.

FICHA TÉCNICA

FINALIDAD PREVISTA	Instrumento diseñado para modelar, pulir y adaptar materiales de obturación (como composites) en restauraciones dentales directas.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Guardar en condiciones limpias y secas. Esterilizar antes del primer uso y tras cada uso clínico. Evitar contacto con productos corrosivos o agresivos. Transportar en contenedores quirúrgicos apropiados o envases originales.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.