


FICHA TÉCNICA



ALICATE O'BRIEN PROCLINIC, PUNTAS 1,2; 1,6; 2 mm

REFERENCIA	L8790
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Alicate O'Brien para doblar alambres de ortodoncia. Longitud: 130 mm ● \varnothing : 1,2; 1,6; 2 mm
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.
ENVASE	Envase con 1 unidad.
FINALIDAD PREVISTA	Instrumental de uso por profesionales dentales para para doblar alambres de ortodoncia de hasta 0,7 mm \varnothing .
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de procesamiento adecuados.
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET

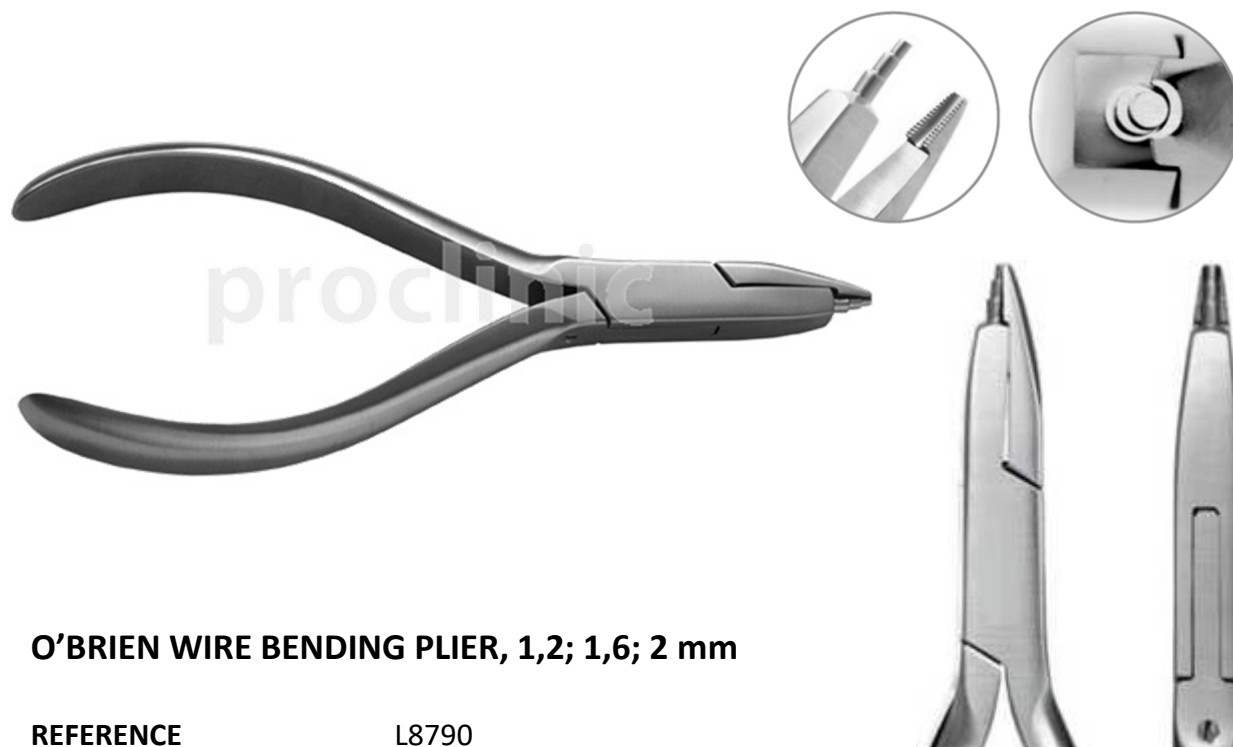

O'BRIEN WIRE BENDING PLIER, 1,2; 1,6; 2 mm

REFERENCE	L8790
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
DESCRIPTION	O'Brien wire bending plier. Length: 130 mm ● Ø: 1,2; 1,6; 2 mm
COMPOSITON	Stainless steel.
PACKAGING	Package with 1 piece.
INTENDED USE	Instrument for use only by dental professionals intended for bending orthodontic wires up to 0,7 mm Ø.
SHELF LIFE	The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**PINZA O'BRIEN PROCLINIC, PUNTE 1,2; 1,6; 2 mm****CODICE ARTICOLO** L8790**PRODOTTO DA** CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl
Via Felice Cavallotti, 15
20122 Milano - Italia**NOTE TECNICHE** Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.**DESCRIZIONE** Pinza O'Brien per piegare fili ortodontici.
Lunghezza: 130 mm
● Ø: 1,2; 1,6; 2 mm**MATERIALE DI PRODUZIONE** Acciaio inossidabile.**IMBALLAGGIO** Singolo pezzo.**DESTINAZIONE D'USO** Strumento solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale destinato alla piegatura di fili ortodontici fino a 0,7 mm Ø.**DATA DI SCADENZA** La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.**STERILIZZAZIONE** Tutti gli strumenti devono essere ispezionati, puliti e sterilizzati prima dell'uso. Usare detergenti e disinfettanti adatti per l'uso con strumenti medici o odontoiatrici.
Sterilizzare con autoclave o a secco.**STOCCAGGIO** Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.